# medimex Ink Test und Ink Test für Tyvek und Ultra Verpackungsmaterial

## Gebrauchsanleitung in Deutsch

8M50490003 / 8M50490004


Der medimex Ink Test und Ink Test für Tyvek und Ultra Verpackungsmaterial ist ein Siegelnahtdichtigkeits-test zur Routineüberprüfung von Siegelnähten gemäß DIN EN ISO 11607-1 Anhang B, sowie ASTM F1929. Unregelmäßigkeiten in den Siegelnähten (Kanalbildungen etc.) werden sofort nach dem Entleeren der Testflüssigkeit sichtbar. Es sind keine weiteren Hilfsmittel erforderlich.Der hier verwendete Test ist komplett Triton X frei.

**Vorbereitung**


Ziehen Sie sich bitte stets Handschuhe an! Schützen Sie den Arbeitsbereich durch eine entsprechende Unterlage.
Für eventuelle entstehende Verunreinigungen übernehmen wir keine Haftung.


**Testdurchführung**

- Bereiten Sie ein ca. 25cm langes Stück Sterilisationsbeutel mit einer Breite von mind. 15cm vor.
- Versiegeln Sie ein Ende des Sterilisationsbeutel.
- Legen Sie den Ink Test mittig mit dem Flaschenhals nach oben in den Beutel ein. (Bild 1)
- Verschweißen Sie nun die offene Seite des Beutels.
- Halten Sie die Flasche mit dem Daumen fest und knicken die Öffnung nach oben ab. (Bild 2)
- Drücken Sie die Tinte aus der Flasche aus.
- Lassen Sie nun die Testflüssigkeit an jeder Seite des Sterilisationsbeutels max. 5 Sekunden einwirken (durch Spannen und Drehen desBeutels - 4 Seiten Test. (Bild 3-4)

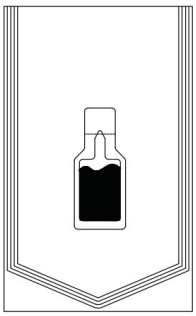



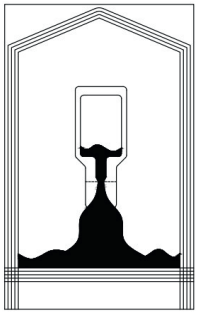

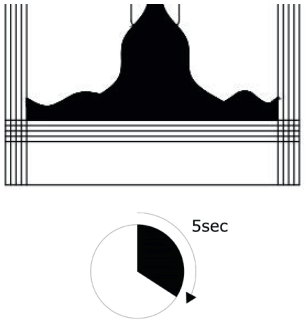


Sie sollten nun keine Kanalbildung oder ähnliche Unregelmäßigkeiten feststellen (visuelle Prüfung). Entsorgen Sie anschließend den mit Tinte gefüllten Beutel vorsichtig in einem Abfallbehälter. Gleiches lässt sich mit bereits vorgefertigtem Sterilisationsbeutel durchführen.

**Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen. Bei Hautreizungen bitte einen Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt: Sofort bei geöffneter Lidspalte 10-15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Anschließend bitte einen Arzt aufsuchen.
Nach Verschlucken: Mund gründlich ausspülen. Niemals darf einem Bewusstlosen etwas über den Mund verabreicht werden. Kein Erbrechen ohne ärztliche Anweiseung herbeiführen. Bei Beschwerden bitte einen Arzt aufsuchen.

**medimex GmbH**
In den Fritzenstücker 9 –11
D-65549 Limburg
www.medimex.de

8M50490003 / 4 - BA001787-1
Stand: 08-2026